













L01.605.903**Set für MIS Posteriore Instrumente****Box01/02**

| Pos. | Mat.Nr | Description | | Qty | Unit | Location |
|----------|------------|---|--|-----|------|----------|
| Box01/02 | | Tray 01 | | | | |
| 1 | 03.605.513 | Rongeur, gebogen, 2.0 mm, schwarz |  | 1 | ST | B01T01 |
| 2 | 03.605.514 | Rongeur, gebogen, 4.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 3 | 03.605.515 | Rongeur, gebogen, 6.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 4 | 03.605.520 | Laminektomiestanze, 40°, 4.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 5 | 03.605.521 | Laminektomiestanze, 40°, 2.0 mm, schwarz |  | 1 | ST | B01T01 |
| 6 | 03.605.522 | Laminektomiestanze, 90°, 4.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 7 | 03.605.523 | Laminektomiestanze, 90°, 2.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 8 | 03.605.526 | Rongeur, gerade, 2.0 mm, schwarz |  | 1 | ST | B01T01 |
| 9 | 03.605.527 | Rongeur, gerade, 4.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 10 | 03.605.528 | Rongeur, gerade, 6.0 mm, schwarz | | 1 | ST | B01T01 |
| 11 | 68.605.900 | Vario Case™ für MIPI, Teil 1, mit Deckel, ohne Inhalt |  | 1 | ST | B01T01 |
| 12 | 689.507 | Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™ |  | 1 | ST | B01T01 |
| Box01/02 | | Tray 02 | | | | |
| 13 | 03.605.500 | Impaktor, Standard, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |
| 14 | 03.605.501 | Implantatstößel, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |
| 15 | 03.605.507 | Raspel, doppelseitig, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |
| 16 | 03.605.511 | Raspel, doppelseitig, abgewinkelt, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |
| 17 | 03.605.531 | Impaktor, gross, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |
| 18 | 03.605.532 | Impaktor, gebogen, Standard, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |
| 19 | 03.605.533 | Impaktor, gebogen, gross, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B01T02 |

Depuy Synthes GmbH Im Brunnenfeld 8
OrthoKit® Rental Service D-79224 Umkirch


www.depuysynthes.com



L01.605.903

Set für MIS Posteriore Instrumente

Einsatz 1/1 Nr. 1 zu Vario Case 68.605.900







1 ST B01T02

Box02/02

| Pos. | Mat.Nr | Description | | Qty | Unit | Location |
|----------|------------|--|--|-----|------|----------|
| Box02/02 | | Tray 01 | | | | |
| 20 | 03.605.503 | Kürette, rechteckig, links, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 21 | 03.605.510 | Ringkürette, gerade, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 22 | 03.605.529 | Kürette, rechteckig, abgewinkelt, rechts, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 23 | 03.605.530 | Kürette, rechteckig, abgewinkelt, links, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 24 | 03.605.534 | Ringkürette, gebogen, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 25 | 03.605.536 | Kürette, rechteckig, rechts, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 26 | 03.803.054 | Kürette, rechteckig, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T01 |
| 27 | 68.605.910 | Vario Case™ für MIPI, Teil 2, mit Deckel, ohne Inhalt | | 1 | ST | B02T01 |
| 28 | 689.507 | Stahldeckel, Größe 1/1, für Vario Case™ | | 1 | ST | B02T01 |
| Box02/02 | | Tray 02 | | | | |
| 29 | 03.605.502 | Endplattenraspatorium, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T02 |
| 30 | 03.605.504 | Knochenkürette, 5.5 mm, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T02 |
| 31 | 03.605.505 | Knochenkürette, 45° gebogen, 5.5 mm, kurz, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T02 |
| 32 | 03.605.506 | Knochenkürette, 45° gebogen, 5.5 mm, mittel, versetzt, schwarz | | 1 | ST | B02T02 |
| 33 | 03.605.508 | Osteotom, gerade, schwarz | | 1 | ST | B02T02 |

L01.605.903**Set für MIS Posteriore Instrumente**

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|---|----|--------|
| 34 | 03.605.509 | Knochenkürette, 90° gebogen, 5.5 mm, versetzt, schwarz |  | 1 | ST | B02T02 |
| 35 | 03.605.524 | Dissektor, stumpf, 4.0 mm, schwarz |  | 1 | ST | B02T02 |
| 36 | 03.605.525 | Dissektor, stumpf, 2.0 mm, schwarz |  | 1 | ST | B02T02 |
| | | Einsatz 1/1 Nr. 1 zu Vario Case 68.605.910 |  | 1 | ST | B02T02 |

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuythes.com




L01.605.903

Set für MIS Posteriore Instrumente

B01T01

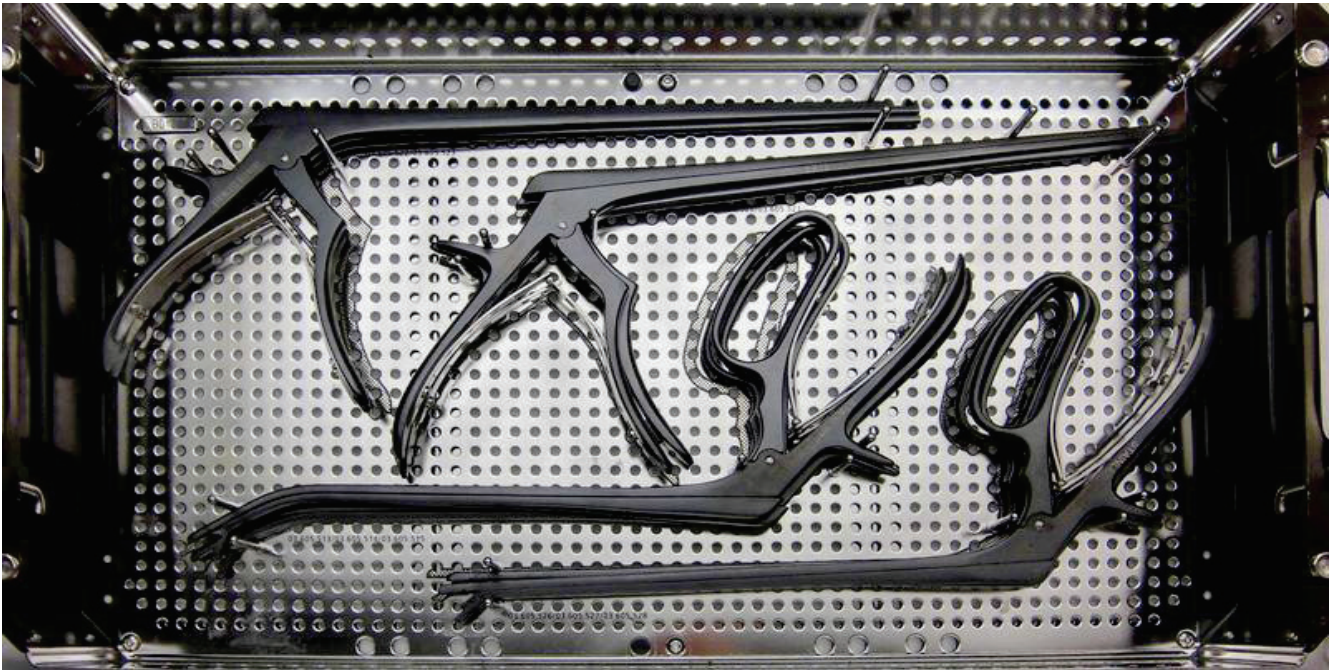


B01T02

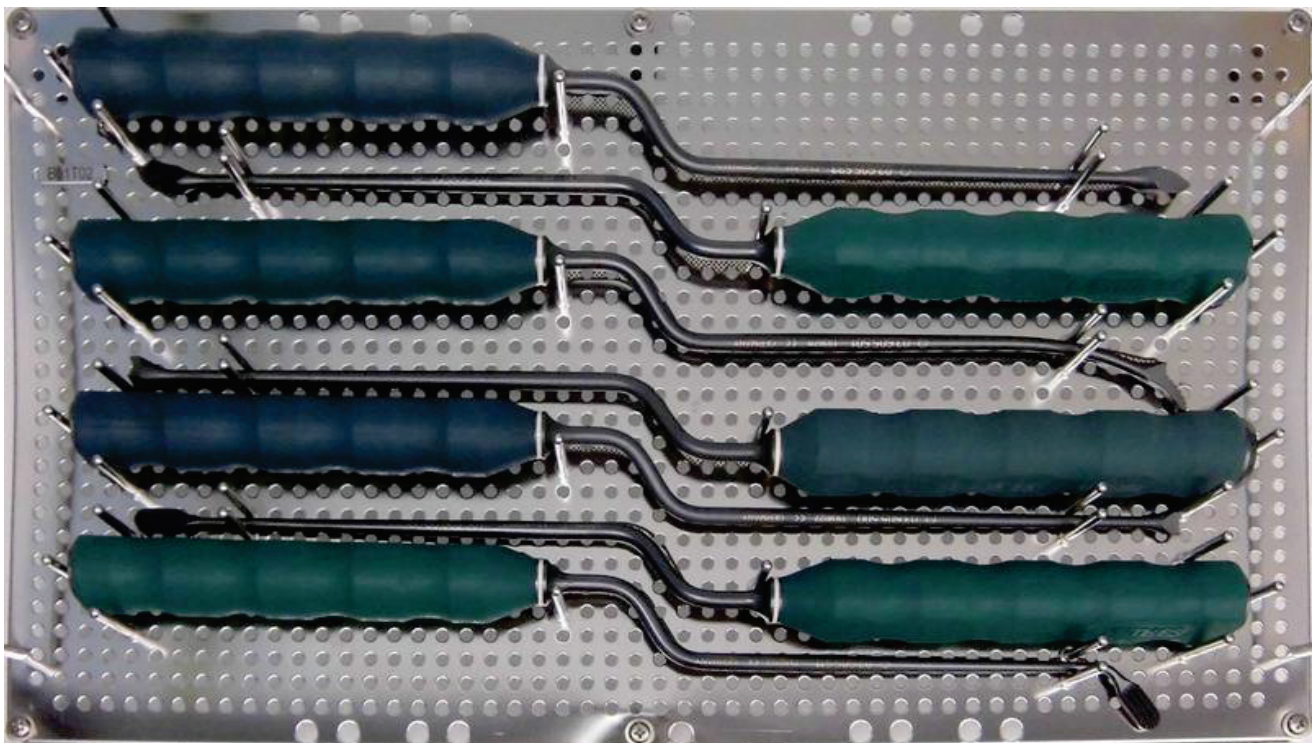


L01.605.903

Set für MIS Posteriore Instrumente

B02T01

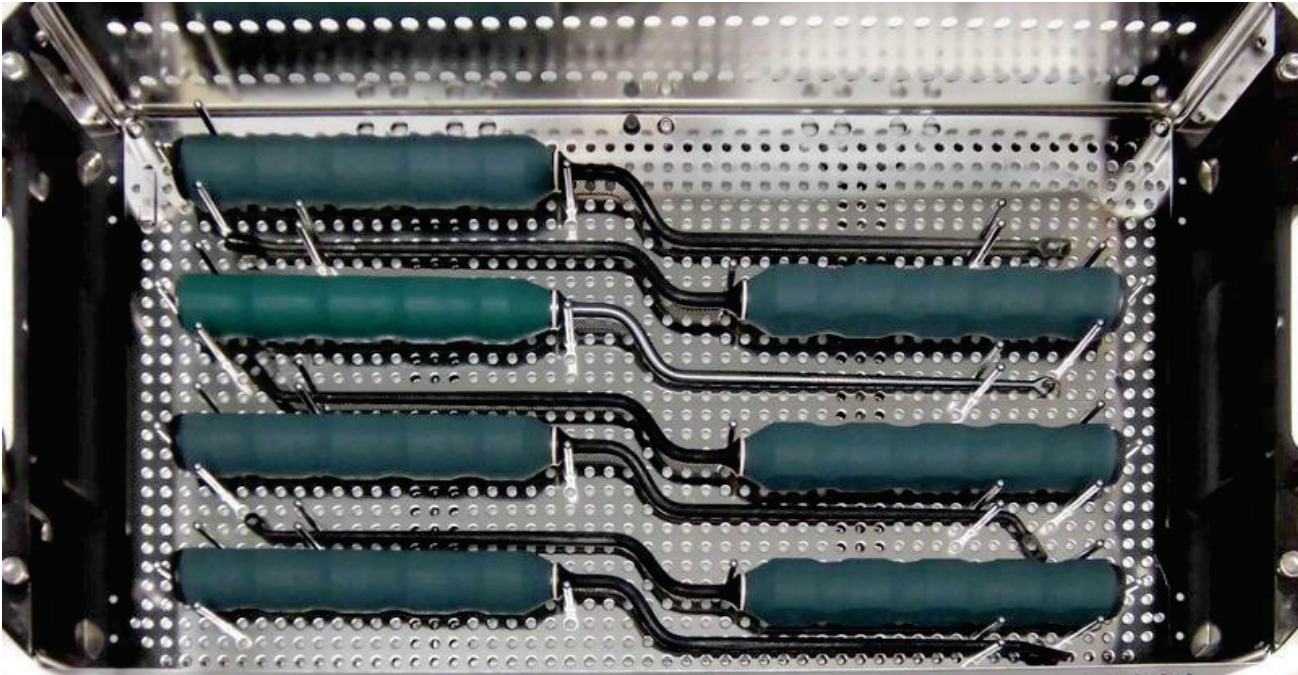

B02T02

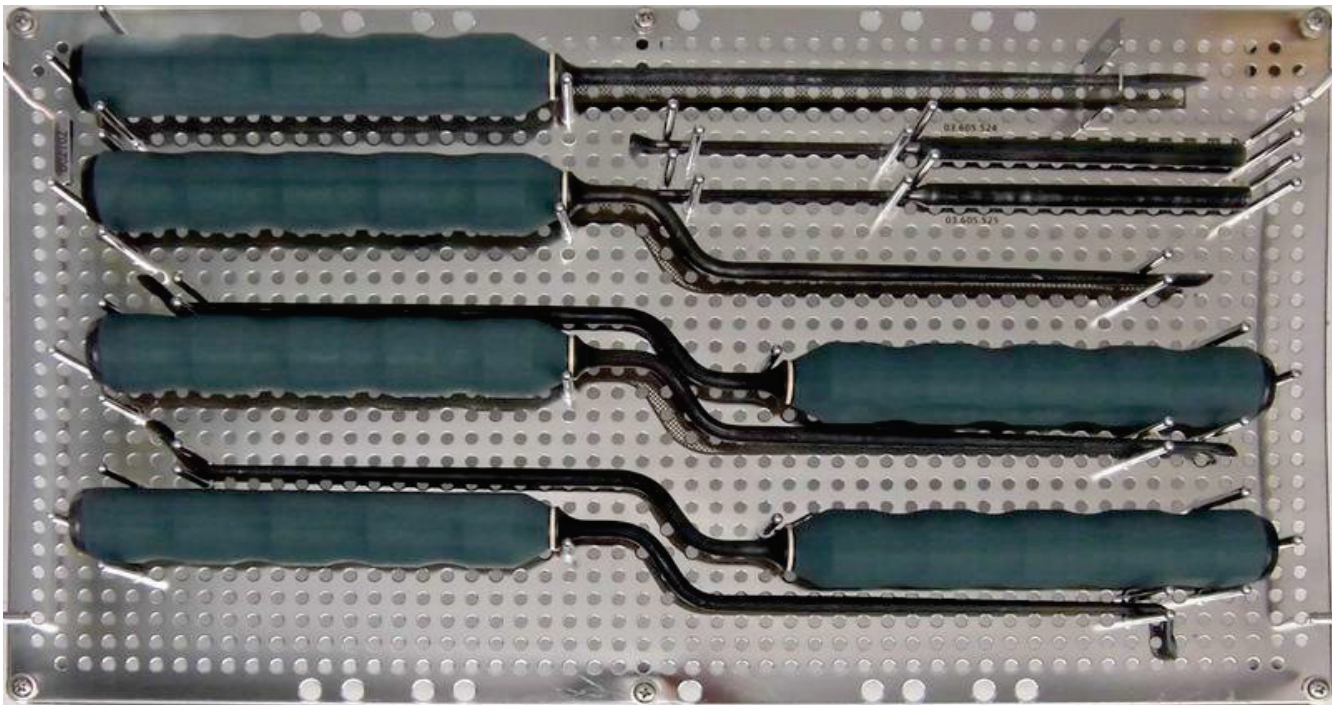

End of document